MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

NEDERLANDS

SNELSTARTGIDS

GT-500EC

TDS/EC-meter

EC 0 – 20.000 µS/cm · TDS 0 – 10.000 ppm · ATC

Zo meet u in een paar minuten. Lees eerst de veiligheidsinstructies op de achterzijde.



1 In de verpakking

- TDS/EC-meter GT-500EC met beschermkap
- 4 knoopcellen LR44 (al in het toestel)
- Snelstartgids

Apart verkrijgbaar op meytec.eu:
Geleidbaarheidsstandaard 12.880 µS/cm (12,88 mS/cm), Geleidbaarheidsstandaard 1.413 µS/cm

Volledige handleiding

Scan de QR-code. Op de pagina Handleidingen van meytec.eu vindt u de volledige handleiding om te downloaden.
meytec.eu/nl-be/downloads/handleidingen/

Aan de slag

2 Inschakelen


1. Verwijder de beschermkap van de elektrode.
2. Druk op ON/OFF. Het toestel gaat aan.

De knoopcellen zitten al in het toestel. Toont de batterij-indicator een lege batterij? Vervang ze dan (zie de handleiding).

> ⚠ **Draai beide kappen stevig dicht, de beschermkap onderaan over de sensor en het batterijvak bovenaan, en schroef het sensorgedeelte goed vast, zodat het toestel waterdicht blijft. Water in het toestel door een los batterijvak of sensorgedeelte valt niet onder de garantie.**

3 Kalibreren

WELKE PUNTEN?	
1 punt: 12.880	In 12.880 µS/cm kalibreren. Daarna niet opnieuw op MODE/CAL drukken.
1 punt: 1.413	Kort op MODE/CAL drukken, dan in 1.413 µS/cm kalibreren.
2 punten	12.880 µS/cm, afspoelen, kort op MODE/CAL, dan 1.413 µS/cm.

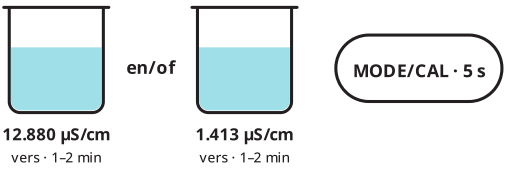


1. Open een vers zakje of flesje van de standaard die u nodig hebt. Kalibreer nooit rechtstreeks in een fles: giet een kleine hoeveelheid in een schone beker, of kalibreer in het zakje (eenmalig gebruik).
2. Plaats de meter in de standaard, tussen de MIN- en de MAX-lijn, en schud zachtjes. Houd MODE/CAL 5 seconden ingedrukt: de kalibratiemodus start op 12.880 µS/cm.
3. Voor 1.413 µS/cm: druk kort op MODE/CAL. De meter schakelt over en kalibreert automatisch verder. Voor 12.880 µS/cm drukt u niet opnieuw.
4. Wacht tot de waarde volledig stabiel is (1 tot 2 minuten).
5. Spoel af en schud droog. Bij 2 punten: meter in 1.413 µS/cm, kort op MODE/CAL en opnieuw wachten tot de waarde stabiel is.

Spoel de meter af en plaats de beschermkap terug.

4 Meten

1. Verwijder de beschermkap.
2. Druk op ON/OFF.
3. Kies EC of TDS: druk kort op MODE/CAL.
4. Dompel de meter alleen in tot de sensor onder water zit, tussen de MIN- en de MAX-lijn. Dompel de meter nooit volledig onder.
5. Wacht tot de meting volledig stabiel is en lees de EC-waarde of de TDS-waarde (ppm) af. De meter compenseert de temperatuur automatisch (ATC).
6. Druk eventueel kort op HOLD/TEMP om de waarde vast te houden.
7. Spoel de elektrode af met schoon water, schakel het toestel uit en plaats de beschermkap terug.

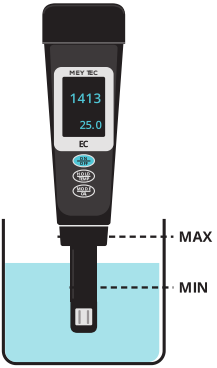

EC EN TDS

EC (elektrische geleidbaarheid) is de gemeten geleidbaarheid van het water, in µS/cm (1.000 µS/cm = 1 mS/cm). TDS (totaal opgeloste stoffen) is een schatting in ppm die de meter uit de EC-waarde omrekent: 1.000 ppm = 1 g/l.

5 Afspoelen en opbergen

- Spoel de elektrode na elk gebruik af met leidingwater of gedemineraliseerd water.
- Plaats de beschermkap altijd terug.
- Bewaar het toestel met de beschermkap op.
- Bewaar het op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

SNELLE HULP

PROBLEEM	OPLOSSING
Het scherm blijft leeg.	Vervang de 4 knoopcellen LR44 (zie de handleiding op meytec.eu).
De waarde blijft veranderen.	Dompel het toestel onder tot tussen de MIN- en de MAX-lijn en wacht tot de waarde stabiel is.
De waarde lijkt niet te kloppen.	Kalibreer opnieuw met een verse geleidbaarheidsstandaard: 12.880 µS/cm en/of 1.413 µS/cm.

Blijft het probleem bestaan? Neem contact op met Meytec via info@meytec.eu of +32 3 377 83 23. Vermeld het model en uw ordernummer.

Veiligheid

⚠ Knoopcellen (LR44)

- Houd nieuwe en gebruikte knoopcellen buiten het bereik van kinderen.
- Een ingeslikte knoopcel kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken.
- Vermoedt u dat iemand een knoopcel heeft ingeslikt of in het lichaam heeft gebracht? Zoek onmiddellijk medische hulp en bel 112.
- België: Antigifcentrum 070 245 245. Nederland: bel 112, uw huisarts of de huisartsenpost.
- Laad de knoopcellen niet op. Open ze niet, verbrand ze niet en sluit ze niet kort.
- Sluit het batterijvak altijd goed. Gebruik het toestel niet als het batterijvak niet goed sluit.

- IP65: stofdicht en bestand tegen waterstralen. Dompel het toestel nooit volledig onder en nooit dieper dan de MAX-lijn.
- Bewaar het toestel buiten het bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Volg de veiligheidsinformatie op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad van elke vloeistof.

AFVOER EN RECYCLAGE

De doorgestreepte vuilnisbak betekent: gooi dit toestel en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lever ze gescheiden in. Zo kunnen de materialen opnieuw gebruikt worden en komen er geen schadelijke stoffen in het milieu. Toestel: in België op het recyclagepark of bij een verkooppunt dat elektrische toestellen terugneemt. In Nederland bij de milieustraat of een inzamelpunt in de winkel. Haal de knoopcellen uit het toestel voordat u het inlevert. Lever lege knoopcellen gratis en apart in. In Nederland kan dat in elke winkel die batterijen verkoopt, bij een Wecycle-inleverpunt of op de milieustraat. In België kan dat bij elk Bebat-inzamelpunt of op het recyclagepark. De doorgestreepte vuilnisbak op de batterij betekent: niet bij het huishoudelijk afval, apart inleveren.

VERPAKKING 21 PAP **Doos** · PAP 21 · Oud papier 1 PET **Inzet** · PET 1 · PMD

Volg altijd de sorteerregels van uw gemeente.

CONFORMITEIT

CE Dit toestel voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU (EMC) en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2015/863. De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen via info@meytec.eu.

PRODUCTIDENTIFICATIE

Type	**TDS/EC-meter**
Model	**GT-500EC**
EAN	**5407007391837**
Lotnummer	**zie de verpakking**

FABRIKANT EN CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
België
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Volledige handleiding downloaden
meytec.eu/nl-be/downloads/handleidingen/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES