MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DANSK

BRUGSANVISNING

GT-500PH

pH-måler

Digital pH-måler til pool, spa og akvarium

pH 0,00 – 14,00
måleområde

± 0,05 pH
nøjagtighed

3 punkter
automatisk kalibrering

4 × LR44
batterier allerede i apparatet

ATC
automatisk temperaturkompensation

i Læs denne brugsanvisning før første brug, og gem den til senere brug.



Om dette apparat

Meytec GT-500PH er en digital pH-måler i lommeformat. Med den måler De pH og temperatur i en væske, hurtigt og nøjagtigt.

Egnet til pool, spa, akvarium og vandbehandling. Den ideelle pH i poolvand ligger som regel mellem 7,2 og 7,6. Følg altid brugsanvisningen til Deres anlæg.

INDHOLD

1	Emballagens indhold	2	7	Vedligeholdelse og opbevaring	8
2	Sikkerhed	3	8	Fejlfinding	9
3	Oversigt over apparatet	4	9	Tekniske specifikationer	10
4	Første brug	5	10	Reklamationsret	10
5	Kalibrering	6	11	Bortskaffelse og genanvendelse	11
6	Måling	7	12	Overensstemmelse og kontakt	12

1 Emballagens indhold

I EMBALLAGEN

- pH-måler GT-500PH med beskyttelseshætte
- 4 knapceller LR44 (allerede i apparatet)
- Kvikguide

FÅS SEPARAT PÅ MEYTEC.EU

- pH-kalibreringsvæsker pH 4.01, pH 7.00 og pH 10.01



2 Sikkerhed

Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt. Så bruger De apparatet sikkert og undgår skader.

⚠ Knapceller (LR44)

- Opbevar nye og brugte knapceller utilgængeligt for børn.
- En slugt knapcelle kan inden for 2 timer forårsage alvorlige indre forbrændinger.
- Har De mistanke om, at nogen har slugt en knapcelle eller har fået en ind i kroppen? Søg straks lægehjælp, og ring 112.
- Danmark: Giftlinjen 82 12 12 12, døgnet rundt.
- Oplad ikke knapcellerne. Åbn dem ikke, brænd dem ikke, og kortslut dem ikke.
- Luk altid batterirummet godt. Brug ikke apparatet, hvis batterirummet ikke lukker ordentligt.


Brug

- IP65: støvtæt og modstandsdygtig over for vandstråler. Nedsænk aldrig apparatet helt og aldrig dybere end MAX-stregen.
- Skru begge hætter godt fast, beskyttelseshætten forneden over sensoren og batterirummet foroven, og skru sensordelen godt fast, så apparatet forbliver vandtæt. Vand i apparatet på grund af et løst batterirum eller en løs sensordel er ikke omfattet af reklamationsretten.
- Mål kun inden for temperaturområdet 0 til 50 °C.
- Tab ikke apparatet, og stød ikke elektroden mod noget.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Det er ikke legetøj.

Kalibreringsvæsker og poolvand

- Følg sikkerhedsoplysningerne på etiketten og i sikkerhedsdatabladet for hver væske.
- Skyl grundigt med vand efter kontakt med huden eller øjnene.

3 Oversigt over apparatet

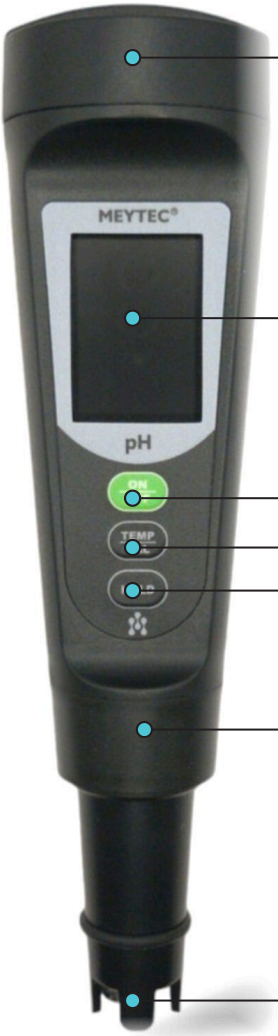

1 **Batterirum**
Foroven, til 4 knapceller LR44.

2 **Skærm**
Viser pH, temperaturen og batteriindikatoren.

3 **ON/OFF**
Tænder eller slukker apparatet.

4 **TEMP/CAL**
Skifter mellem °C og °F eller starter kalibreringen.

5 **HOLD**
Fastholder måleværdien.

6 **MAX-streg**
Nedsænk aldrig apparatet dybere end denne streg.


7 **pH-elektrode**
Sensoren, under beskyttelseshætten.

Taster og skærm

TASTERNE

ON/OFF	Kort tryk: apparatet tændes eller slukkes.
TEMP/CAL	Kort tryk: skift mellem °C og °F. Hold inde i 5 sekunder: kalibreringstilstanden åbnes. I kalibreringstilstand: tryk kort, så snart værdien er stabil.
HOLD	Kort tryk: måleværdien bliver stående på skærmen. Tryk igen for at fortsætte målingen.

SKÆRMEN



- (A) Batteriindikator
- (B) pH-værdi
- (C) Enhed
- (D) Temperatur i °C eller °F


4 Første brug

1. Pak apparatet ud, og kontrollér, at alt er til stede og ubeskadiget.
2. Fjern beskyttelseshætten fra elektroden.
3. Tryk på ON/OFF. Apparatet tændes.
4. Kalibrér apparatet i 3 punkter, før De måler første gang (se kapitel 5).

> **TIP**
> Forbliver skærmen tom? Kontrollér knapcellerne (se kapitel 7).

5 Kalibrering

Ved at kalibrere tilpasser De apparatet til væsker med en kendt pH. Så forbliver målingen nøjagtig.

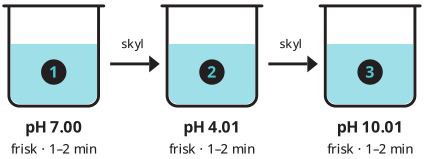


NY ELLER IKKE KALIBRERET I LANG TID	I 3 punkter: pH 7.00, 4.01 og 10.01, for korrekt nøjagtighed.
DEREFTER	I 1 eller 2 punkter: pH 7.00 og 4.01 eller pH 7.00 og 10.01, afhængigt af hvor den målte værdi ligger.
POOL	Omkring pH 7: De kan nøjes med at kalibrere på pH 7.00. Kalibrér dog regelmæssigt igen i 3 punkter.

1. Tag pH-måleren, og åbn et friskt brev eller en frisk flaske kalibreringsvæske. Kalibrér aldrig direkte i en flaske: hæld en lille mængde i et rent bæger, eller kalibrér direkte i brevet (engangsbrug). Start altid med pH 7.00.
2. Sæt måleren i væsken, og ryst forsigtigt med måleren. Ved det første punkt åbner De kalibreringstilstanden: hold TEMP/CAL inde i 5 sekunder.
3. Vent, til værdien på skærmen er helt stabil; det kan tage 1 til 2 minutter. Tryk først derefter på TEMP/CAL: måleren genkender selv pH-værdien og kalibrerer på denne værdi.
4. Skyl måleren, og ryst den tør.
5. Sæt måleren i den næste pH-værdi (pH 4.01 eller pH 10.01), og gentag samme proces. De vælger altså med væsken, hvilke punkter De kalibrerer.

Efter det sidste punkt sætter De beskyttelseshætten på igen. Fejlmeddelelse? Så afviger værdien for meget: prøv igen med frisk kalibreringsvæske. Er sensoren slidt, skal måleren udskiftes. En mangel, der allerede var til stede ved leveringen, er omfattet af reklamationsretten.

6 Måling


1. Fjern beskyttelseshætten.
2. Tryk på ON/OFF.
3. Nedsænk kun måleren, indtil sensoren er under vand, ikke dybere end MAX-stregen. Nedsænk aldrig måleren helt.
4. Vent, til pH-værdien er helt stabil, og aflæs den. Måleren kompenserer automatisk for temperaturen (ATC).
5. Tryk eventuelt på HOLD for at fastholde værdien.
6. Skyl elektroden med rent vand, sluk apparatet, og sæt beskyttelseshætten på igen.

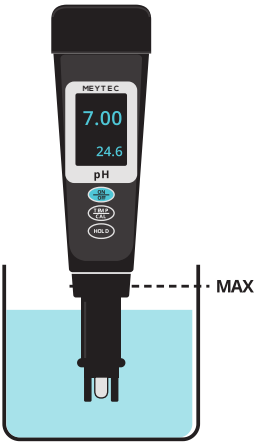

Nedsænkning: aldrig dybere end MAX-stregen.

VEJLEDENDE VÆRDI

Ideel pH i poolvand: som regel 7,2 til 7,6.



Følg altid brugsanvisningen til Deres anlæg.

7 Vedligeholdelse og opbevaring

VEDLIGEHOLDELSE

- Skyl elektroden med rent vand efter hver brug.
- Sæt altid beskyttelseshætten på igen. Lad aldrig elektroden tørre ud.
- Kalibrér regelmæssigt med friske kalibreringsvæsker.

OPBEVARING

- Opbevar apparatet med beskyttelseshætten på.
- Opbevar det et tørt sted, utilgængeligt for børn.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Knapcellerne sidder allerede i apparatet ved levering. Viser batteriindikatoren et tomt batteri? Udskift så alle 4 knapceller på én gang med 4 nye knapceller LR44.

1. Sluk apparatet med ON/OFF.
2. Åbn batterirummet (1) øverst på apparatet.
3. Tag de 4 knapceller ud. Isæt 4 nye knapceller LR44, og vær opmærksom på + og –.
4. Skru batterirummet godt fast, så apparatet forbliver vandtæt.
5. Aflever de tomme knapceller på et indsamlingssted for batterier (se kapitel 11).

⚠ Vandtæthed

IP65: støvtæt og modstandsdygtig over for vandstråler. Må ikke nedsænkes helt. Skru altid batterirummet og sensordelen godt fast, så måleren forbliver vandtæt. Vand i apparatet på grund af et løst batterirum eller en løs sensordel er ikke omfattet af reklamationsretten.

8 Fejlfinding

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Skærmen forbliver tom.	Knapcellerne er afladede.	Udskift de 4 knapceller LR44 (se kapitel 7).
Batteriindikatoren står lavt.	Knapcellerne er ved at blive afladede.	Udskift alle 4 knapceller på én gang.
Værdien bliver ved med at ændre sig.	Målingen er endnu ikke stabil.	Vent, til værdien er helt stabil. Det kan tage 1 til 2 minutter.
Værdien ser ikke ud til at være korrekt.	Apparatet er ikke kalibreret for nylig, eller kalibreringsvæsken er ikke frisk.	Kalibrér igen med friske væsker i 3 punkter.
Værdien ændrer sig ikke længere.	HOLD er aktiv.	Tryk på HOLD for at fortsætte målingen.
Temperaturen vises i °F.	Enheden er ændret.	Tryk kort på TEMP/CAL for at skifte tilbage til °C.
Målingen er langsom eller ustabil efter lang tids opbevaring.	Elektroden er snavset eller udtørret.	Skyl elektroden med rent vand, og kalibrér i 3 punkter.
Fejlmeddelelse ved kalibrering.	Værdien afviger for meget fra kalibreringsvæsken.	Prøv igen med frisk kalibreringsvæske. Er sensoren slidt, skal måleren udskiftes. En mangel, der allerede var til stede ved leveringen, er omfattet af reklamationsretten.

Fortsætter problemet? Kontakt Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Oplys modellen og Deres ordrenummer.

9 Tekniske specifikationer

Model	GT-500PH
Måleområde	pH 0,00 – 14,00
Nøjagtighed	± 0,05 pH
Temperatur	0,0 – 50,0 °C
Temperaturenhed	°C eller °F
Temperaturkompensation	Automatisk (ATC)
Kalibrering	Automatisk, 1 til 3 punkter: pH 4.01, 7.00 og 10.01
Kapslingsklasse	IP65: støvtæt og modstandsdygtig over for vandstråler. Må ikke nedsænkes helt.
Strømforsyning	4 knapceller LR44
Batteriindikator	Ja
EAN	5407007391646

10 Reklamationsret

Som forbruger har De reklamationsret i 2 år fra leveringen eller den længere beskyttelse, som ufravigelige regler i bopælslandet giver. Den gælder for mangler, der allerede var til stede ved leveringen, fx en fabrikationsfejl i måleren, skærmen, elektronikken, huset eller den indbyggede elektrode. Viser en sådan mangel sig inden for de 2 år, går vi ud fra, at den allerede var til stede ved leveringen, medmindre vi kan påvise det modsatte. Meytec yder ingen yderligere kommerciel garanti.

Den indbyggede elektrode er en forbrugsvare: den slides fra første brug og kan ikke udskiftes separat. Normalt slid er ikke en mangel.

Reklamationsretten dækker ikke skader og fejl, der opstår efter leveringen, såsom en udtørret elektrode; skader efter fald eller stød; vand i apparatet, fordi batterirummet eller sensordelen ikke var skruet godt fast, eller fordi måleren blev nedsænket dybere end MAX-stregen eller helt; skader fra lækkende batterier; frost, varme eller opbevaring, der ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning; rengøring, kalibrering eller brug, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning; samt reparationer eller indgreb foretaget af tredjemand. Anmeld et problem via info@meytec.eu, og vedlæg Deres faktura.

11 Bortskaffelse og genanvendelse



Den overkrydsede affaldsspand betyder: Smid ikke dette apparat og batterierne ud som restaffald. Aflever dem separat. Så kan materialerne genbruges, og der slipper ingen skadelige stoffer ud i miljøet.

Danmark: Aflever apparatet gratis via kommunens indsamlingsordning, typisk på genbrugsstationen.

I andre lande afleveres apparatet og batterierne gratis på et kommunalt indsamlingssted (genbrugsstation) eller i en butik, der tager elektrisk og elektronisk udstyr retur.

BATTERIER



- Tag knapcellerne ud af apparatet, før De afleverer det.
- Aflever brugte knapceller gratis og separat efter kommunens anvisning, fx i en pose oven på skraldespanden, i den røde kasse til farligt affald eller i en batteriboks.
- Batterier kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og helbredet. Ved at aflevere dem separat gør De genanvendelse mulig.
- Sådan begrænser De affaldet: Brug apparatet så længe som muligt, og udskift kun knapcellerne, når de er tomme.
- Den overkrydsede affaldsspand på batteriet betyder: ikke som restaffald, aflever separat.

EMBALLAGE



Æske
PAP 21
Pap



Indlæg
PET 1
Plast

Følg altid Deres kommunes sorteringsregler.

12 Overensstemmelse og kontakt

Dette apparat overholder direktiv 2014/30/EU (EMC) og direktiv 2011/65/EU (RoHS) som ændret ved direktiv (EU) 2015/863. EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Type	**pH-måler**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Lotnummer	**se emballagen**
Oprindelsesland	**Kina**

PRODUCENT OG KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien

Elektronisk post	**info@meytec.eu**
Telefon	**+32 3 377 83 23**
Hjemmeside	**meytec.eu**
Virksomhedsnummer	**BE 0747.687.975**

Brugsanvisninger og filer
meytec.eu/da/downloads/brugsanvisninger/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Brugsanvisning til pH-måler GT-500PH · Dansk · Version 1.0 · oktober 2026