MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

BRUKSANVISNING

GT-500PH

pH-mätare

Digital pH-mätare för pool, spa och akvarium

pH 0,00 – 14,00
mätområde

± 0,05 pH
noggrannhet

3 punkter
automatisk kalibrering

4 × LR44
batterier redan i apparaten

ATC
automatisk temperaturkompensation

i Läs denna bruksanvisning före första användningen och spara den för framtida bruk.



Om denna apparat

Meytec GT-500PH är en digital pH-mätare i fickformat. Den mäter pH och temperatur i en vätska, snabbt och noggrant.

Lämplig för pool, spa, akvarium och vattenbehandling. Det ideala pH-värdet i poolvatten ligger oftast mellan 7,2 och 7,6. Följ alltid anläggningens bruksanvisning.

INNEHÅLL

1	Förpackningens innehåll	2	7	Underhåll och förvaring	8
2	Säkerhet	3	8	Felsökning	9
3	Översikt över apparaten	4	9	Tekniska specifikationer	10
4	Första användningen	5	10	Reklamationsrätt	10
5	Kalibrering	6	11	Kassering och återvinning	11
6	Mätning	7	12	Överensstämmelse och kontakt	12

1 Förpackningens innehåll

I FÖRPACKNINGEN

- pH-mätare GT-500PH med skyddslock
- 4 knappcellsbatterier LR44 (redan i apparaten)
- Snabbstartsguide

SÄLJS SEPARAT PÅ MEYTEC.EU

- pH-kalibreringsvätskor pH 4.01, pH 7.00 och pH 10.01



2 Säkerhet

Läs dessa säkerhetsanvisningar noggrant. Då används apparaten säkert och skador undviks.

⚠ Knappcellsbatterier (LR44)

- Förvara nya och använda knappcellsbatterier utom räckhåll för barn.
- Ett nedsvalt knappcellsbatteri kan orsaka allvarliga inre brännskador inom 2 timmar.
- Misstänks någon ha svalt ett knappcellsbatteri eller fört in det i kroppen? Sök omedelbart medicinsk hjälp och ring 112.
- Belgien: Giftinformationscentralen (Antigifcentrum) 070 245 245. Nederländerna: ring 112, husläkaren eller jourmottagningen.
- Ladda inte knappcellsbatterierna. Öppna dem inte, bränn dem inte och kortslut dem inte.
- Stäng alltid batterifacket ordentligt. Använd inte apparaten om batterifacket inte stänger ordentligt.


Användning

- IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Sänk aldrig ned apparaten helt och aldrig djupare än MAX-linjen.
- Skruva fast båda locken ordentligt, skyddslocket nedtill över sensorn och batterifacket upptill, och skruva fast sensordelen ordentligt, så att apparaten förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.
- Mät endast inom temperaturområdet 0 till 50 °C.
- Tappa inte apparaten och stöt inte elektroden mot något.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Den är ingen leksak.

Kalibreringsvätskor och poolvatten

- Följ säkerhetsinformationen på etiketten och i säkerhetsdatabladet för varje vätska.
- Skölj noggrant med vatten efter kontakt med huden eller ögonen.

3 Översikt över apparaten

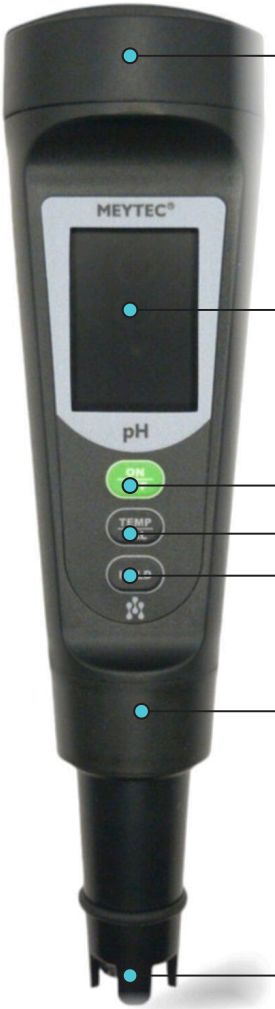

1 Batterifack
Upptill, för 4 knappcellsbatterier LR44.

2 Display
Visar pH, temperatur och batteriindikator.

3 ON/OFF
Apparat på eller av.

4 TEMP/CAL
Växla mellan °C och °F, eller starta kalibrering.

5 HOLD
Hålla kvar mätvärdet.

6 MAX-linje
Sänk aldrig ned apparaten djupare än denna linje.


7 pH-sond
Sensorn, under skyddslocket.

Knappar och display

KNAPPARNA

ON/OFF	Kort tryck: apparaten slås på eller av.
TEMP/CAL	Kort tryck: växla mellan °C och °F. Håll intryckt i 5 sekunder: kalibreringsläget öppnas. I kalibreringsläget: kort tryck när värdet är stabilt.
HOLD	Kort tryck: mätvärdet ligger kvar på displayen. Tryck igen för att fortsätta mäta.

DISPLAYEN



- A Batteriindikator
- B pH-värde
- C Enhet
- D Temperatur i °C eller °F


4 Första användningen

1. Packa upp apparaten och kontrollera att allt finns med och är oskadat.
2. Ta av skyddslocket från elektroden.
3. Tryck på ON/OFF. Apparaten slås på.
4. Kalibrera apparaten i 3 punkter före den första mätningen (se kapitel 5).

> **TIPS**
> Förblir displayen tom? Kontrollera knappcellsbatterierna (se kapitel 7).

5 Kalibrering

Genom kalibrering anpassas apparaten till vätskor med känt pH. Då förblir mätningen noggrann.

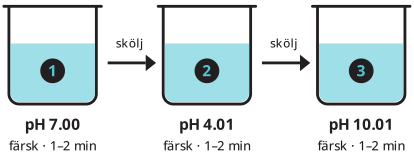


NY ELLER LÄNGE INTE KALIBRERAD	I 3 punkter: pH 7.00, 4.01 och 10.01, för korrekt noggrannhet.
DÄREFTER	I 1 eller 2 punkter: pH 7.00 och 4.01, eller pH 7.00 och 10.01, beroende på var det uppmätta värdet ligger.
POOL	Kring pH 7: det går att fortsätta kalibrera endast i pH 7.00. Kalibrera ändå regelbundet på nytt i 3 punkter.

1. Ta pH-mätaren och öppna en ny påse eller en ny flaska kalibreringsvätska. Kalibrera aldrig direkt i en flaska: häll en liten mängd i en ren bägare, eller kalibrera direkt i påsen (engångsbruk). Börja alltid med pH 7.00.
2. Placera mätaren i vätskan och skaka mätaren försiktigt. Vid den första punkten öppnas kalibreringsläget: håll TEMP/CAL intryckt i 5 sekunder.
3. Vänta tills värdet på displayen är helt stabilt; det kan ta 1 till 2 minuter. Tryck först då på TEMP/CAL: mätaren känner själv igen pH-värdet och kalibrerar på det värdet.
4. Skölj av mätaren och skaka den torr.
5. Placera mätaren i nästa pH-värde (pH 4.01 eller pH 10.01) och upprepa samma procedur. Vilka punkter som kalibreras väljs alltså med vätskan.

Sätt tillbaka skyddslocket efter den sista punkten. Felmeddelande? Då avviker värdet för mycket: försök igen med färsk kalibreringsvätska. Är sensorn utsliten måste mätaren bytas ut. Ett fel som fanns redan vid leveransen omfattas av reklamationsrätten enligt lag.

6 Mätning


1. Ta av skyddslocket.
2. Tryck på ON/OFF.
3. Sänk endast ned mätaren tills sensorn är under vatten, inte djupare än MAX-linjen. Sänk aldrig ned mätaren helt.
4. Vänta tills pH-värdet är helt stabilt och läs av det. Mätaren kompenserar temperaturen automatiskt (ATC).
5. Tryck vid behov på HOLD för att hålla kvar värdet.
6. Skölj av elektroden med rent vatten, stäng av apparaten och sätt tillbaka skyddslocket.

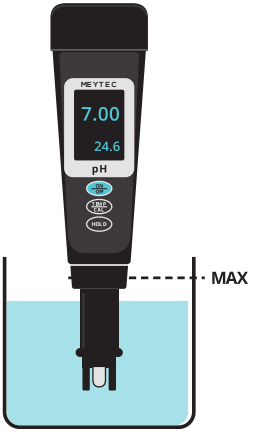

Nedsänkning: aldrig djupare än MAX-linjen.

RIKTVÄRDE

Idealt pH i poolvatten: oftast 7,2 till 7,6.



Följ alltid anläggningens bruksanvisning.

7 Underhåll och förvaring

UNDERHÅLL

- Skölj av elektroden med rent vatten efter varje användning.
- Sätt alltid tillbaka skyddslocket. Låt aldrig elektroden torka ut.
- Kalibrera regelbundet med färska kalibreringsvätskor.

FÖRVARING

- Förvara apparaten med skyddslocket på.
- Förvara den på en torr plats, utom räckhåll för barn.

BYTA BATTERIER

Knappcellsbatterierna sitter redan i apparaten vid leverans. Visar batteriindikatorn ett tomt batteri? Byt då alla 4 knappcellsbatterier samtidigt mot 4 nya knappcellsbatterier LR44.

1. Stäng av apparaten med ON/OFF.
2. Öppna batterifacket (1) upptill på apparaten.
3. Ta ut de 4 knappcellsbatterierna. Sätt i 4 nya knappcellsbatterier LR44 och observera + och −.
4. Skruva fast batterifacket ordentligt, så att apparaten förblir vattentät.
5. Lämna de tomma knappcellsbatterierna till en insamlingsplats för batterier (se kapitel 11).

Hålla vattentät

IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Får inte sänkas ned helt. Skruva alltid fast batterifacket och sensordelen ordentligt, så att mätaren förblir vattentät. Vatten i apparaten på grund av ett löst batterifack eller en lös sensordel är inget fel som omfattas av reklamationsrätten.

8 Felsökning

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Displayen förblir tom.	Knappcellsbatterierna är tomma.	Byt de 4 knappcellsbatterierna LR44 (se kapitel 7).
Batteriindikatorn står lågt.	Knappcellsbatterierna håller på att ta slut.	Byt alla 4 knappcellsbatterier samtidigt.
Värdet fortsätter att ändras.	Mätningen är ännu inte stabil.	Vänta tills värdet är helt stabilt. Det kan ta 1 till 2 minuter.
Värdet verkar inte stämma.	Apparaten har inte kalibrerats nyligen, eller kalibreringsvätskan är inte färsk.	Kalibrera på nytt med färska vätskor, i 3 punkter.
Värdet ändras inte längre.	HOLD är aktiverat.	Tryck på HOLD för att fortsätta mäta.
Temperaturen visas i °F.	Enheten har ändrats.	Tryck kort på TEMP/CAL för att gå tillbaka till °C.
Mätningen är långsam eller instabil efter lång förvaring.	Elektroden är smutsig eller uttorkad.	Skölj av elektroden med rent vatten och kalibrera i 3 punkter.
Felmeddelande vid kalibrering.	Värdet avviker för mycket från kalibreringsvätskan.	Försök igen med färsk kalibreringsvätska. Är sensorn utsliten måste mätaren bytas ut. Ett fel som fanns redan vid leveransen omfattas av reklamationsrätten enligt lag.

Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

9 Tekniska specifikationer

Modell	GT-500PH
Mätområde	pH 0,00 – 14,00
Noggrannhet	± 0,05 pH
Temperatur	0,0 – 50,0 °C
Temperaturenhet	°C eller °F
Temperaturkompensation	Automatisk (ATC)
Kalibrering	Automatisk, 1 till 3 punkter: pH 4.01, 7.00 och 10.01
Kapslingsklass	IP65: dammtät och skyddad mot vattenstrålar. Får inte sänkas ned helt.
Strömförsörjning	4 knappcellsbatterier LR44
Batteriindikator	Ja
EAN	5407007391646

10 Reklamationsrätt

Som konsument har ni reklamationsrätt enligt lag i 3 år från leveransen. Den gäller fel som fanns redan vid leveransen, till exempel ett tillverkningsfel i mätaren, displayen, elektroniken, höljet eller den inbyggda elektroden. Upptäcks ett sådant fel inom 2 år från leveransen utgår vi från att det fanns redan vid leveransen, om vi inte visar motsatsen. Meytec lämnar ingen garanti utöver reklamationsrätten enligt lag.

Den inbyggda elektroden är en förbrukningsvara: den slits från första användningen och kan inte bytas ut separat. Normalt slitage är inget fel.

Reklamationsrätten omfattar inte skador och störningar som uppstår efter leveransen, till exempel en uttorkad elektrod; fall- eller stötskador; vatten i apparaten på grund av att batterifacket eller sensordelen inte var ordentligt fastskruvade, eller på grund av att mätaren sänktes ned djupare än MAX-linjen eller helt; skador från läckande batterier; frost, värme eller förvaring som inte följer denna bruksanvisning; rengöring, kalibrering eller användning som inte beskrivs i denna bruksanvisning; samt reparationer eller ingrepp av tredje part. Anmäl ett problem till info@meytec.eu och bifoga fakturan.

11 Kassering och återvinning



Den överkorsade soptunnan betyder: släng inte denna apparat och batterierna i hushållsavfallet. Lämna dem separat. Då kan materialen återanvändas och inga skadliga ämnen hamnar i miljön.

Nederländerna: lämna apparaten kostnadsfritt på kommunens återvinningscentral (milieustraat) eller vid en insamlingsplats för Wecycle (wecycle.nl). Köps en ny apparat med samma funktion? Då tar säljaren tillbaka den gamla apparaten kostnadsfritt, även vid köp i en webbutik. Butiker med minst 400 m² försäljningsyta för elektriska apparater tar emot små apparater (upp till 25 cm) kostnadsfritt, även utan köp.

Belgien: lämna apparaten på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater.

I andra länder lämnar ni apparaten och batterierna kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter.

BATTERIER



- Ta ut knappcellsbatterierna ur apparaten innan den lämnas in.
- Lämna tomma knappcellsbatterier kostnadsfritt och separat. I Nederländerna går det i varje butik som säljer batterier, vid en insamlingsplats för Wecycle eller på kommunens återvinningscentral (milieustraat). I Belgien går det vid varje insamlingsplats för Bebat eller på återvinningscentralen (recyclagepark).
- Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och hälsan. Genom att lämna dem separat blir återvinning möjlig.
- Så minskas avfallet: använd apparaten så länge som möjligt och byt endast knappcellsbatterierna när de är tomma.
- Den överkorsade soptunnan på batteriet betyder: släng inte i hushållsavfallet, lämna separat.

FÖRPACKNING



Kartong
PAP 21
Returpapper



Insats
PET 1
Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

12 Överensstämmelse och kontakt

Denna apparat uppfyller direktiv 2014/30/EU (EMC) och direktiv 2011/65/EU (RoHS), ändrat genom direktiv (EU) 2015/863. EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras via info@meytec.eu.

PRODUKTIDENTIFIERING

Typ	**pH-mätare**
Modell	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Lotnummer	**se förpackningen**
Ursprungsland	**Kina**

TILLVERKARE OCH KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien

E-post	**info@meytec.eu**
Telefon	**+32 3 377 83 23**
Webbplats	**meytec.eu**
Organisationsnummer	**BE 0747.687.975**

Bruksanvisningar och nedladdningar
meytec.eu/sv/nedladdningar/bruksanvisningar/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Bruksanvisning pH-mätare GT-500PH · Svenska · Version 1.0 · oktober 2026