MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

POLSKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA

GT-500PH

pH-metr

Tak wykonuje się pomiar w kilka minut. Najpierw należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa na odwrocie.



1 Zawartość opakowania

- pH-metr GT-500PH z nasadką ochronną
- 4 baterie guzikowe LR44 (już w urządzeniu)
- Skrócona instrukcja

Dostępne osobno na meytec.eu: Roztwory kalibracyjne pH 4.01, pH 7.00 i pH 10.01

Pełna instrukcja

Zeskanować kod QR. Na stronie Instrukcje w serwisie meytec.eu znajduje się pełna instrukcja do pobrania.
meytec.eu/pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/

Pierwsze kroki

2 Włączanie


1. Zdjąć nasadkę ochronną z elektrody.
2. Nacisnąć ON/OFF. Urządzenie włącza się.

Baterie guzikowe są już w urządzeniu. Jeśli wskaźnik baterii pokazuje pustą baterię, należy je wymienić (patrz instrukcja).

> ⚠ **Obie nasadki należy mocno zakręcić, nasadkę ochronną na dole na czujniku i komorę baterii na górze, a część z czujnikiem dobrze przykręcić, aby urządzenie pozostało wodoszczelne. Woda w urządzeniu z powodu luźnej komory baterii lub luźnej części z czujnikiem nie stanowi niezgodności towaru z umową.**

3 Kalibracja

KTÓRE PUNKTY?	
Nowe lub dawno niekalibrowane	W 3 punktach: pH 7.00, 4.01 i 10.01, aby zapewnić prawidłową dokładność.
Później	W 1 lub 2 punktach: pH 7.00 i 4.01 albo pH 7.00 i 10.01, w zależności od tego, gdzie leży mierzona wartość.
Basen	W okolicach pH 7: można kalibrować tylko przy pH 7.00. Mimo to należy regularnie kalibrować ponownie w 3 punktach.




1. Wziąć pH-metr i otworzyć świeżą saszetkę lub świeżą butelkę roztworu kalibracyjnego. Nigdy nie kalibrować bezpośrednio w butelce: należy nalać niewielką ilość do czystego kubka lub kalibrować bezpośrednio w saszetce (jednorazowo). Zawsze zaczynać od pH 7.00.
2. Umieścić miernik w roztworze i delikatnie nim poruszać. W pierwszym punkcie otworzyć tryb kalibracji: przytrzymać TEMP/CAL przez 5 sekund.
3. Poczekać, aż wartość na wyświetlaczu będzie całkowicie stabilna; może to potrwać od 1 do 2 minut. Dopiero wtedy nacisnąć TEMP/CAL: miernik sam rozpoznaje wartość pH i kalibruje się na tę wartość.
4. Opłukać miernik i strząsnąć wodę.
5. Umieścić miernik w kolejnym roztworze pH (pH 4.01 lub pH 10.01) i powtórzyć tę samą procedurę. Punkty kalibracji wybiera się więc roztworem.

Następnie: założyć nasadkę ochronną. Komunikat o błędzie? Spróbować ponownie. Jeżeli czujnik jest zużyty, miernik należy wymienić. Wada istniejąca już w chwili dostawy jest objęta ustawowymi uprawnieniami z tytułu niezgodności towaru z umową.


4 Pomiar

1. Zdjąć nasadkę ochronną.
2. Nacisnąć ON/OFF.
3. Zanurzyć miernik tylko tak głęboko, aby czujnik znalazł się pod wodą, nie głębiej niż do linii MAX. Nigdy nie zanurzać miernika całkowicie.
4. Poczekać, aż wartość pH będzie całkowicie stabilna, i odczytać ją. Miernik automatycznie kompensuje temperaturę (ATC).
5. W razie potrzeby nacisnąć HOLD, aby zatrzymać wartość.
6. Opłukać elektrodę czystą wodą, wyłączyć urządzenie i założyć nasadkę ochronną.

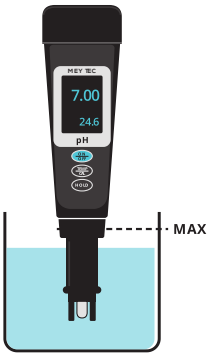

WARTOŚĆ ORIENTACYJNA

Idealne pH wody basenowej: zwykle od 7,2 do 7,6.



Należy zawsze przestrzegać instrukcji swojej instalacji.

5 Płukanie i przechowywanie

- Po każdym użyciu opłukać elektrodę czystą wodą.
- Zawsze zakładać nasadkę ochronną. Nigdy nie dopuszczać do wyschnięcia elektrody.
- Przechowywać urządzenie z założoną nasadką ochronną.
- Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

SZYBKA POMOC

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Wyświetlacz pozostaje pusty.	Wymienić 4 baterie guzikowe LR44 (patrz instrukcja na meytec.eu).
Wartość ciągle się zmienia.	Poczekać, aż wartość będzie całkowicie stabilna. Może to potrwać od 1 do 2 minut.
Wartość wydaje się nieprawidłowa.	Ponownie skalibrować świeżymi roztworami, w 3 punktach.

Problem nadal występuje? Prosimy o kontakt z Meytec pod adresem info@meytec.eu lub numerem +32 3 377 83 23, podając model i numer zamówienia.

Bezpieczeństwo

⚠ Baterie guzikowe (LR44)

- Nowe i zużyte baterie guzikowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Połknięta bateria guzikowa może w ciągu 2 godzin spowodować poważne oparzenia wewnętrzne.
- W razie podejrzenia, że ktoś połknął baterię guzikową lub umieścił ją w ciele, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej i zadzwonić pod numer 112.
- Belgia: Centrum Toksykologiczne (Antigifcentrum) 070 245 245. Holandia: należy zadzwonić pod numer 112, do lekarza rodzinnego lub do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.
- Baterii guzikowych nie należy ładować. Nie otwierać ich, nie wrzucać do ognia i nie zwierać.
- Komorę baterii należy zawsze dobrze zamykać. Nie używać urządzenia, jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo.

- IP65: pyłoszczelne i odporne na strumienie wody. Nigdy nie zanurzać urządzenia całkowicie ani głębiej niż do linii MAX.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. To nie jest zabawka.
- Należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa na etykiecie i w karcie charakterystyki każdego roztworu.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Przekreślony kontener na odpady oznacza: nie wyrzucać tego urządzenia ani baterii razem z odpadami domowymi. Należy oddać je osobno. Dzięki temu materiały mogą zostać ponownie wykorzystane, a szkodliwe substancje nie przedostają się do środowiska. Urządzenie: w Belgii w punkcie recyklingu (recyclagepark) lub w punkcie sprzedaży, który przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny. W Holandii w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w punkcie zbiórki w sklepie. W innych krajach urządzenie i baterie można bezpłatnie oddać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub do sklepu, który przyjmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przed oddaniem urządzenia należy wyjąć z niego baterie guzikowe. Zużyte baterie guzikowe należy oddawać bezpłatnie i osobno. W Holandii można to zrobić w każdym sklepie sprzedającym baterie, w punkcie zbiórki Wecycle lub w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. W Belgii można to zrobić w każdym punkcie zbiórki Bebat lub w punkcie recyklingu. Przekreślony kontener na baterii oznacza: nie wyrzucać razem z odpadami domowymi, oddać osobno.

OPAKOWANIE 21 PAP **Pudełko** · PAP 21 · Makulatura 1 PET **Wkładka** · PET 1 · Opakowania lekkie

Należy zawsze przestrzegać zasad segregacji odpadów obowiązujących w gminie.

ZGODNOŚĆ

CE Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE (EMC) i dyrektywą 2011/65/UE (RoHS), zmienioną dyrektywą (UE) 2015/863. Deklarację zgodności UE można otrzymać na żądanie pod adresem info@meytec.eu.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Typ	**pH-metr**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Numer partii	**patrz opakowanie**

PRODUCENT I KONTAKT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgia
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Pobierz pełną instrukcję
meytec.eu/pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES