MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

NEDERLANDS

SNELSTARTGIDS

GT-500PH

pH-meter

Zo meet u in een paar minuten. Lees eerst de veiligheidsinstructies op de achterzijde.



1 In de verpakking

- pH-meter GT-500PH met beschermkap
- 4 knoopcellen LR44 (al in het toestel)
- Snelstartgids

Apart verkrijgbaar op meytec.eu: pH-kalibratievloeistoffen pH 4.01, pH 7.00 en pH 10.01

Volledige handleiding

Scan de QR-code. Op de pagina Handleidingen van meytec.eu vindt u de volledige handleiding om te downloaden.
meytec.eu/nl-be/downloads/handleidingen/

Aan de slag

2 Inschakelen


1. Verwijder de beschermkap van de elektrode.
2. Druk op ON/OFF. Het toestel gaat aan.

De knoopcellen zitten al in het toestel. Toont de batterij-indicator een lege batterij? Vervang ze dan (zie de handleiding).

> ⚠ **Draai beide kappen stevig dicht, de beschermkap onderaan over de sensor en het batterijvak bovenaan, en schroef het sensorgedeelte goed vast, zodat het toestel waterdicht blijft. Water in het toestel door een los batterijvak of sensorgedeelte valt niet onder de garantie.**

3 Kalibreren

WELKE PUNTEN?	
Nieuw of lang niet gekalibreerd	Op 3 punten: pH 7.00, 4.01 en 10.01, voor een correcte nauwkeurigheid.
Daarna	Op 1 of 2 punten: pH 7.00 en 4.01, of pH 7.00 en 10.01, afhankelijk van waar de gemeten waarde ligt.
Zwembad	Rond pH 7: u kunt op pH 7.00 alleen blijven kalibreren. Kalibreer toch regelmatig opnieuw op 3 punten.




1. Neem de pH-meter en open een vers zakje of een vers flesje kalibratievloeistof. Kalibreer nooit rechtstreeks in een fles: giet een kleine hoeveelheid in een schone beker, of kalibreer rechtstreeks in het zakje (eenmalig gebruik). Begin altijd met pH 7.00.
2. Plaats de meter in de vloeistof en schud zachtjes met de meter. Bij het eerste punt opent u de kalibratiemodus: houd TEMP/CAL 5 seconden ingedrukt.
3. Wacht tot de waarde op het scherm volledig stabiel is; dat kan 1 tot 2 minuten duren. Druk pas dan op TEMP/CAL: de meter herkent de pH-waarde zelf en kalibreert op die waarde.
4. Spoel de meter af en schud hem droog.
5. Plaats de meter in de volgende pH-waarde (pH 4.01 of pH 10.01) en herhaal hetzelfde proces. Welke punten u kalibreert, kiest u dus met de vloeistof.

Daarna: beschermkap terug. Foutmelding? Probeer opnieuw. Is de sonde versleten, dan moet de meter vervangen worden. Een gebrek dat al bij levering aanwezig was, valt onder de wettelijke garantie.


4 Meten

1. Verwijder de beschermkap.
2. Druk op ON/OFF.
3. Dompel de meter alleen in tot de sensor onder water zit, niet dieper dan de MAX-lijn. Dompel de meter nooit volledig onder.
4. Wacht tot de pH-waarde volledig stabiel is en lees ze af. De meter compenseert de temperatuur automatisch (ATC).
5. Druk eventueel op HOLD om de waarde vast te houden.
6. Spoel de elektrode af met schoon water, schakel het toestel uit en plaats de beschermkap terug.

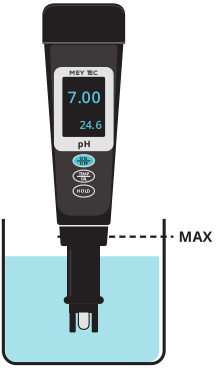

RICHTWAARDE

Ideale pH van zwembadwater: meestal 7,2 tot 7,6.



Volg altijd de handleiding van uw installatie.

5 Afspoelen en opbergen

- Spoel de elektrode na elk gebruik af met schoon water.
- Plaats de beschermkap altijd terug. Laat de elektrode nooit uitdrogen.
- Bewaar het toestel met de beschermkap op.
- Bewaar het op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

SNELLE HULP

PROBLEEM	OPLOSSING
Het scherm blijft leeg.	Vervang de 4 knoopcellen LR44 (zie de handleiding op meytec.eu).
De waarde blijft veranderen.	Wacht tot de waarde volledig stabiel is. Dat kan 1 tot 2 minuten duren.
De waarde lijkt niet te kloppen.	Kalibreer opnieuw met verse vloeistoffen, op 3 punten.

Blijft het probleem bestaan? Neem contact op met Meytec via info@meytec.eu of +32 3 377 83 23. Vermeld het model en uw ordernummer.

Veiligheid

⚠ Knoopcellen (LR44)

- Houd nieuwe en gebruikte knoopcellen buiten het bereik van kinderen.
- Een ingeslikte knoopcel kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken.
- Vermoedt u dat iemand een knoopcel heeft ingeslikt of in het lichaam heeft gebracht? Zoek onmiddellijk medische hulp en bel 112.
- België: Antigifcentrum 070 245 245. Nederland: bel 112, uw huisarts of de huisartsenpost.
- Laad de knoopcellen niet op. Open ze niet, verbrand ze niet en sluit ze niet kort.
- Sluit het batterijvak altijd goed. Gebruik het toestel niet als het batterijvak niet goed sluit.

- IP65: stofdicht en bestand tegen waterstralen. Dompel het toestel nooit volledig onder en nooit dieper dan de MAX-lijn.
- Bewaar het toestel buiten het bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Volg de veiligheidsinformatie op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad van elke vloeistof.

AFVOER EN RECYCLAGE

De doorgestreepte vuilnisbak betekent: gooi dit toestel en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lever ze gescheiden in. Zo kunnen de materialen opnieuw gebruikt worden en komen er geen schadelijke stoffen in het milieu. Toestel: in België op het recyclagepark of bij een verkooppunt dat elektrische toestellen terugneemt. In Nederland bij de milieustraat of een inzamelpunt in de winkel. Haal de knoopcellen uit het toestel voordat u het inlevert. Lever lege knoopcellen gratis en apart in. In Nederland kan dat in elke winkel die batterijen verkoopt, bij een Wecycle-inleverpunt of op de milieustraat. In België kan dat bij elk Bebat-inzamelpunt of op het recyclagepark. De doorgestreepte vuilnisbak op de batterij betekent: niet bij het huishoudelijk afval, apart inleveren.

VERPAKKING 21 PAP **Doos** · PAP 21 · Oud papier 1 PET **Inzet** · PET 1 · PMD

Volg altijd de sorteerregels van uw gemeente.

CONFORMITEIT

CE Dit toestel voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU (EMC) en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2015/863. De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen via info@meytec.eu.

PRODUCTIDENTIFICATIE

Type	**pH-meter**
Model	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Lotnummer	**zie de verpakking**

FABRIKANT EN CONTACT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
België
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Volledige handleiding downloaden
meytec.eu/nl-be/downloads/handleidingen/

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES