MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ITALIANO

GUIDA RAPIDA

GT-500S

Tester di sale

0 – 10.000 ppm di sale (NaCl) · 1.000 ppm = 1 grammo di sale per litro

Così misura in pochi minuti. Legga prima le istruzioni di sicurezza sul retro.



1 Contenuto della confezione

- Tester di sale GT-500S con cappuccio protettivo
- 4 pile a bottone LR44 (già nell'apparecchio)
- Guida rapida

Disponibile separatamente su meytec.eu:
Soluzione di calibrazione conducibilità EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm)

Manuale completo

Scansioni il codice QR. Nella pagina Manuali di meytec.eu trova il manuale completo da scaricare.
meytec.eu/it/download/manuali/

Per iniziare

2 Accensione

1. Rimuova il cappuccio protettivo dall'elettrodo.
2. Prema ON/OFF. L'apparecchio si accende.

Le pile a bottone sono già nell'apparecchio. L'indicatore della batteria mostra una batteria scarica? Le sostituisca allora (vedere il manuale).

> ⚠ **Avviti saldamente entrambi i cappucci, il cappuccio protettivo in basso sul sensore e il vano batterie in alto, e avviti bene la parte del sensore, affinché l'apparecchio resti a tenuta stagna. L'acqua nell'apparecchio dovuta a un vano batterie o a una parte del sensore allentati non è coperta dalla garanzia legale di conformità.**

3 Calibrare

Consigliamo di calibrare l'apparecchio prima della prima misurazione. Soluzione di calibrazione conducibilità EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm), fresca.



12,88 mS/cm
fresca · 1–2 min




1. Prenda il tester di sale e apra una bustina nuova o un flacone nuovo di soluzione di calibrazione EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm). Non calibri mai direttamente in un flacone: versi una piccola quantità in un bicchiere pulito, oppure calibri direttamente nella bustina (monouso).
2. Immerga il tester nella soluzione, tra la linea MIN e la linea MAX, e lo agiti delicatamente. Apra la modalità di calibrazione: tenga premuto MODE/CAL per 5 secondi.
3. Attenda che il valore sul display sia completamente stabile; possono volerci da 1 a 2 minuti. Solo allora prema MODE/CAL: il tester si calibra su 12,88 mS/cm.
4. Sciacqui il tester e lo scuota per asciugarlo.

Dopo la calibrazione, rimetta il cappuccio protettivo.

> **Consiglio:** Per ogni calibrazione utilizzi una bustina nuova o un flacone nuovo di soluzione di calibrazione. Così la calibrazione resta precisa.


4 Misurazione

1. Rimuova il cappuccio protettivo.
2. Prema ON/OFF.
3. Immerga il tester solo finché il sensore è sott'acqua, tra la linea MIN e la linea MAX. Non immerga mai il tester completamente.
4. Attenda che la misurazione sia completamente stabile e legga il contenuto di sale in ppm. Il tester compensa automaticamente la temperatura (ATC).
5. Se necessario, prema brevemente HOLD/TEMP per bloccare il valore.
6. Sciacqui l'elettrodo con acqua pulita, spenga l'apparecchio e rimetta il cappuccio protettivo.

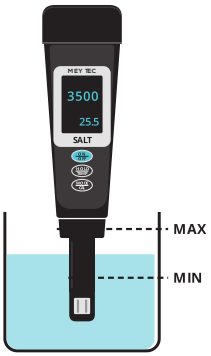

VALORE DI RIFERIMENTO

Contenuto di sale ideale con elettrolisi del sale: di solito da 3 a 5 g/l (da 3.000 a 5.000 ppm).



1.000 ppm equivalgono a 1 grammo di sale per litro. Una misurazione di 4.000 ppm significa quindi 4 g/l.

5 Sciacquare e riporre

- Sciacqui l'elettrodo con acqua pulita dopo ogni utilizzo e in caso di contaminazione.
- Rimetta sempre il cappuccio protettivo.
- Conservi l'apparecchio con il cappuccio protettivo inserito.
- Lo conservi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

AIUTO RAPIDO

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il display resta vuoto.	Sostituisca le 4 pile a bottone LR44 (vedere il manuale su meytec.eu).
Il valore continua a cambiare.	Immerga l'apparecchio fino a una profondità compresa tra la linea MIN e la linea MAX e attenda che il valore sia stabile.
Il valore non sembra corretto.	Ricalibri con una soluzione di calibrazione conducibilità fresca EC 12,88 mS/cm.

Il problema persiste? Contatti Meytec all'indirizzo info@meytec.eu o al numero +32 3 377 83 23. Indichi il modello e il Suo numero d'ordine.

Sicurezza

Pile a bottone (LR44)

- Tenga le pile a bottone nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Una pila a bottone ingerita può causare gravi ustioni interne entro 2 ore.
- Sospetta che qualcuno abbia ingerito una pila a bottone o l'abbia introdotta nel corpo? Cerchi immediatamente assistenza medica e chiami il 112.
- Belgio: Centro antiveleni 070 245 245. Paesi Bassi: chiami il 112, il Suo medico di base o la guardia medica.
- Non ricarichi le pile a bottone. Non le apra, non le bruci e non le metta in cortocircuito.
- Chiuda sempre bene il vano batterie. Non utilizzi l'apparecchio se il vano batterie non si chiude bene.

- IP65: totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua. Non immerga mai l'apparecchio completamente e mai oltre la linea MAX.
- Conservi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
- Segua le informazioni di sicurezza riportate sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza di ogni soluzione.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Il bidone barrato significa: non getti questo apparecchio e le batterie nei rifiuti domestici. Li consegni separatamente. Così i materiali possono essere riutilizzati e nessuna sostanza nociva finisce nell'ambiente. Apparecchio: in Belgio presso il centro di raccolta (recyclagepark) o presso un punto vendita che ritira gli apparecchi elettrici. Nei Paesi Bassi presso l'isola ecologica comunale o un punto di raccolta in negozio. Negli altri Paesi, consegni gratuitamente l'apparecchio e le pile a un centro di raccolta comunale (isola ecologica) o a un negozio che ritira le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rimuova le pile a bottone dall'apparecchio prima di consegnarlo. Consegni le pile a bottone scariche gratuitamente e separatamente. Nei Paesi Bassi è possibile in ogni negozio che vende batterie, presso un punto di raccolta Wecycle o presso l'isola ecologica comunale. In Belgio è possibile presso ogni punto di raccolta Bebat o presso il centro di raccolta. Il bidone barrato sulla batteria significa: non gettare nei rifiuti domestici, consegnare separatamente.

IMBALLAGGIO 21 PAP **Scatola** · PAP 21 · Raccolta carta 1 PET **Inserto** · PET 1 · Raccolta differenziata

Verifichi le disposizioni del Suo Comune.

CONFORMITÀ

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/30/UE (EMC) e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/863. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta a info@meytec.eu.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Tipo	**tester di sale**
Modello	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Numero di lotto	**vedere la confezione**

PRODUTTORE E CONTATTI

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgio
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Scaricare il manuale completo
meytec.eu/it/download/manuali/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES